

Medonic Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle


Boule Con-Diff Normal LOT: 22407-12, Verfall 28.11.2024

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

| | | |
|------------|------------------|---------------|
| RBC | Mittelwert | 4.18 |
| | Standardabw. +/- | 0.18 |
| | Sollbereich | 4.00 bis 4.36 |

Einheit 1012 / L


| Datum | Messwert |
|-------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

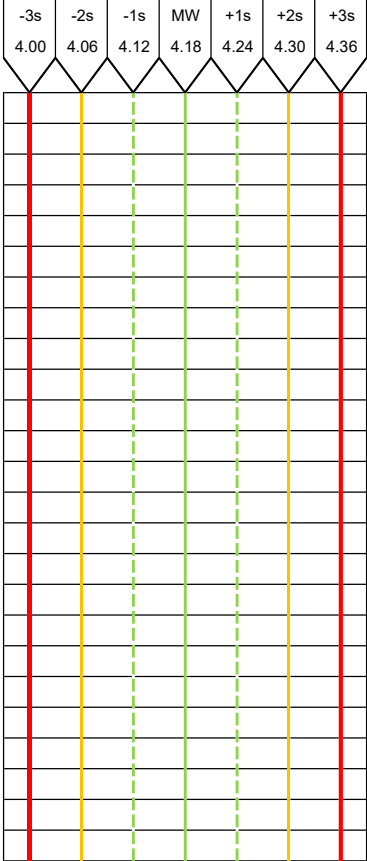

| | | |
|------------|------------------|---------------|
| HCT | Mittelwert | 35.3 |
| | Standardabw. +/- | 3.0 |
| | Sollbereich | 32.3 bis 38.3 |

Einheit %

| Datum | Messwert |
|-------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

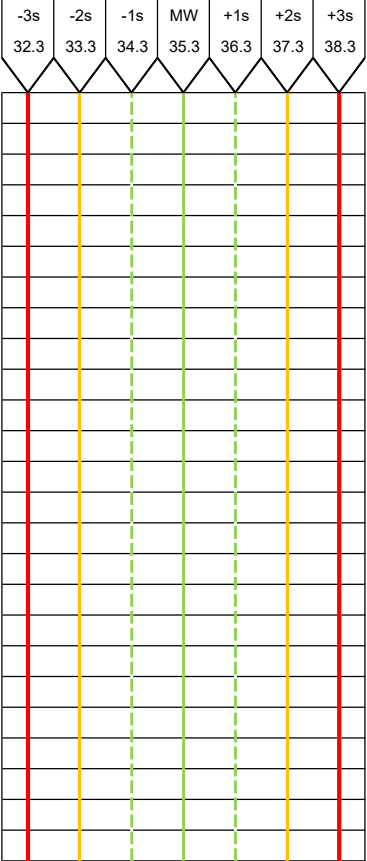

| | | |
|------------|------------------|-------------|
| PLT | Mittelwert | 232 |
| | Standardabw. +/- | 30 |
| | Sollbereich | 202 bis 262 |

Einheit 109 / L

| Datum | Messwert |
|-------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

